



Signatory of APLAC MRA and ILAC MRA

SERTIFIKAT AKREDITASI

LK-068-IDN

Ditetapkan tanggal : 22 Maret 2017

Berlaku hingga : 21 Maret 2021

diberikan kepada

PT. Bukit Asam (Persero), Tbk

di

Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim, Sumatera Selatan, 31716

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

Laboratorium Kalibrasi

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)

Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

Komite Akreditasi Nasional

Prof. Dr. Bambang Prasetya

Ketua

*Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.*

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI LK 068 IDN

Nama Laboratorium	: Laboratorium Kalibrasi PT Bukit Asam Tanjung Enim	Masa berlaku
Alamat	: Jl. Parigi no. 1 Tanjung Enim, Sumatera Selatan – 31716	22 Maret 2017
Telepon	: 0734 - 451096	hingga
Faksimili	: 0734 - 451095	21 Maret 2021
Penandatanganan Sertifikat : Rendra Haryadi; Dahlia (<i>Temperatur, Massa, Tekanan</i>)		

Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran

No	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau yang diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas ^{*)}	Keterangan
1	Temperatur	<i>Enclosure</i>			
		<i>Oven</i>	45 °C ~ 200 °C	1.4 °C	
		<i>Furnace</i>	200 °C ~ 500 °C	1.9 °C	
			500 °C ~ 700 °C	4 °C	
			700 °C ~ 900 °C	4.4 °C	
			900 °C ~ 1000 °C	5.7 °C	
2	Massa	Timbangan Elektronik	0 g ~ 100 g	2 mg	
			100 g ~ 200 g	3 mg	
			200 g ~ 500 g	5.9 mg	
			500 g ~ 1000 g	7.6 mg	
			1000 g ~ 3000 g	10 mg	

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI LK 068 IDN

No	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau yang diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas *)	Keterangan
3	Tekanan	Pressure Gauge	0 psi ~ 100 psi	2.0 psi	1 psi = 6894.8 Pa
			0 psi ~ 200 psi	6 psi	
			0 psi ~ 400 psi	7.5 psi	
			0 psi ~ 1000 psi	12 psi	
			0 psi ~ 3000 psi	22 psi	
			0 psi ~ 5000 psi	31 psi	

Catatan:

- *) Ketidakpastian yang diperluas dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan $k = 2$ yang merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin dengan sumberdaya yang dimiliki laboratorium.
- Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN.

Disahkan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional

Tanggal: 22 Maret 2017



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 23 Januari 2020

Nomor : 0541 /3.b3/LK/1/20
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil
Survailen


Kepada Yth.
Direktur PT Bukit Asam Tanjung
Enim
Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim,
Muara Enim

Dengan ini Komite Akreditasi Nasional memberitahukan bahwa berdasarkan hasil kunjungan pengawasan (survailen) ke-2 tanggal 15 Agustus 2019 dan kunjungan verifikasi lapangan (terkait temuan kategori 1) pada 18 November 2019, KAN memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi sesuai dengan ruang lingkup yang diakreditasi dan penyesuaian terhadap SNI ISO/IEC 17025:2017 kepada laboratorium kalibrasi:

Nama : PT Bukit Asam Tanjung Enim
Alamat : Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, Muara Enim
No. Akreditasi : LK 068 IDN

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal

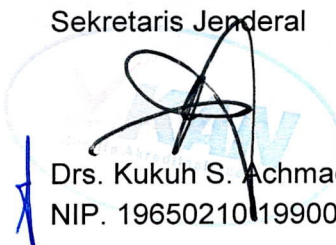

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc. *ny*
NIP. 19650210199003 1 002